



540000/273/25/2018-ZAP

Wykonawcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu informuje, że do prowadzącego postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) do Inspektoratu ZUS w Koninie”

w dniu 25 września 2018 r. wpłynęło **pytanie** o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora AED z baterią, 1 kompletem elektrod, szafką mocowaną na ścianie zamykanej na kluczyk, apteczka AED / zestaw ratunkowy (maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki jednorazowe, gaza, nożyczki, golarka), instrukcja obsługi i znaki AED, o parametrach wskazanych poniżej:

Primedica AED to przenośny nowoczesny dwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled Defibrillation) gwarantujący bezpieczeństwo użytkownika, dzięki utrzymywaniu natężenia prądu na stałym niskim poziomie i dostosowaniu czasu trwania impulsu.

Defibrylatory z grupy Heartsave przeznaczone są dla miejsc publicznych, firm, budynków użyteczności publicznej, szkół, restauracji, obiektów sportowych, użytkowników domowych, domów opieki itp. Defibrylator odporny na wstrząsy i zabrudzenia.

Dzięki swej budowie urządzenie jest w zasadzie bezobsługowe, codzienne „autotesty” (system auto – kontroli) informują nas o stanie urządzenia a samo włączenie się jest automatyczne po otwarciu pokrywy urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic,

6 letnia nieładowna bateria zapewniająca do 200 wyładowań, ze wskaźnikiem aktualnego poziomu energii,

Elektrody wstępnie podłączone z 3 letnim terminem przydatności, w kpl. z maszynką, nożyczkami, rękawiczkami, maseczką do RKO,

4 języki obsługi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Węgierski),

Dołączona karta pamięci pozwala na przechowywanie danych oraz ich weryfikację poprzez załączone oprogramowanie ECG Viewer,

Obudowa z wysokiej jakości tworzywa zapewnia wytrzymałość na upadek z 1m. Klasa bezpieczeństwa / stopień ochrony IP55,

NOWE ROZWIĄZANIA :

Przycisk „PEDIATRYCZNY”- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do defibrylacji dziecka poprzez redukcję energii.

Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie” podłączonych elektrod w standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

DEFIBRYLACJA:

- rodzaj impulsu: dwufazowy
- energia: 140 360J
- czas ładowania: <12 s.
- czas analizy: 7-12 s
- próg zatrzymania serca: <200 μ V
- detekcja VF/VT: TAK
- detekcja rozrusznika serca: TAK

EKG:

- metoda: Eindhoven II
- oporność pacjenta: 23-200 Ohm
- częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min

ELEKTRODY:

- elektrody przylepne
- przydatności: 36 miesięcy
- długość kabla: od 1,3 do 2,0 m w zależności od modelu
- aktywna powierzchnia elektrod: 174 cm²
- warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

- pamięć przenośna: karta CF 2 GB przechowująca dane pacjenta oraz zapis głosowy
- oprogramowanie PC

ZASILANIE:

- bateria: LiMnO₂, 15V, 2,8Ah,
- żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200 @360J)

WARUNKI OTOCZENIA:

- warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa)
- warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa)
- klasa bezpieczeństwa IP55

ALGORYTM POSTĘPOWANIA:

- AHA lub ERC 2010 (do wyboru przy składaniu zamówienia)

STANDARDY:

- IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995
- IEC60601-1-2:2001
- IEC60601-1-4:1996+A1:1999
- IEC60601-2-4:2002
- EN1789:2003

WYMIARY:

- wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm
- waga z baterią: około 2,5kg

AKCESORIA DO DEFIBRYLATORA


Szafka na defibrylator zamykana na kluczyk,

Opis produktu:

1. Wykonana z blachy czarnej malowanej proszkowo
2. Kolor czerwony
3. Wymiary: 400/400/200
4. Oznaczenie AED
5. Instrukcja użycia defibrylatora GRATIS!

Tablica Informacyjna AED – 2 szt.

Wysięgnik metalowy z oznakowaniem fluorescencyjnym do zawieszenia nad szafką w celu wyraźnego oznakowania miejsca, w którym znajduje się urządzenie (również po zmroku).

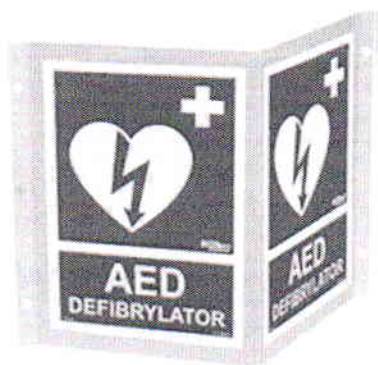

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę defibrylatora AED, którego parametry spełniają wymagania wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego z dnia 20-09-2018 r.) oraz odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 24-09-2018 r.

Od momentu otrzymania wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy są związani ich treścią.

DYREKTOR

Mirostawa Drjański